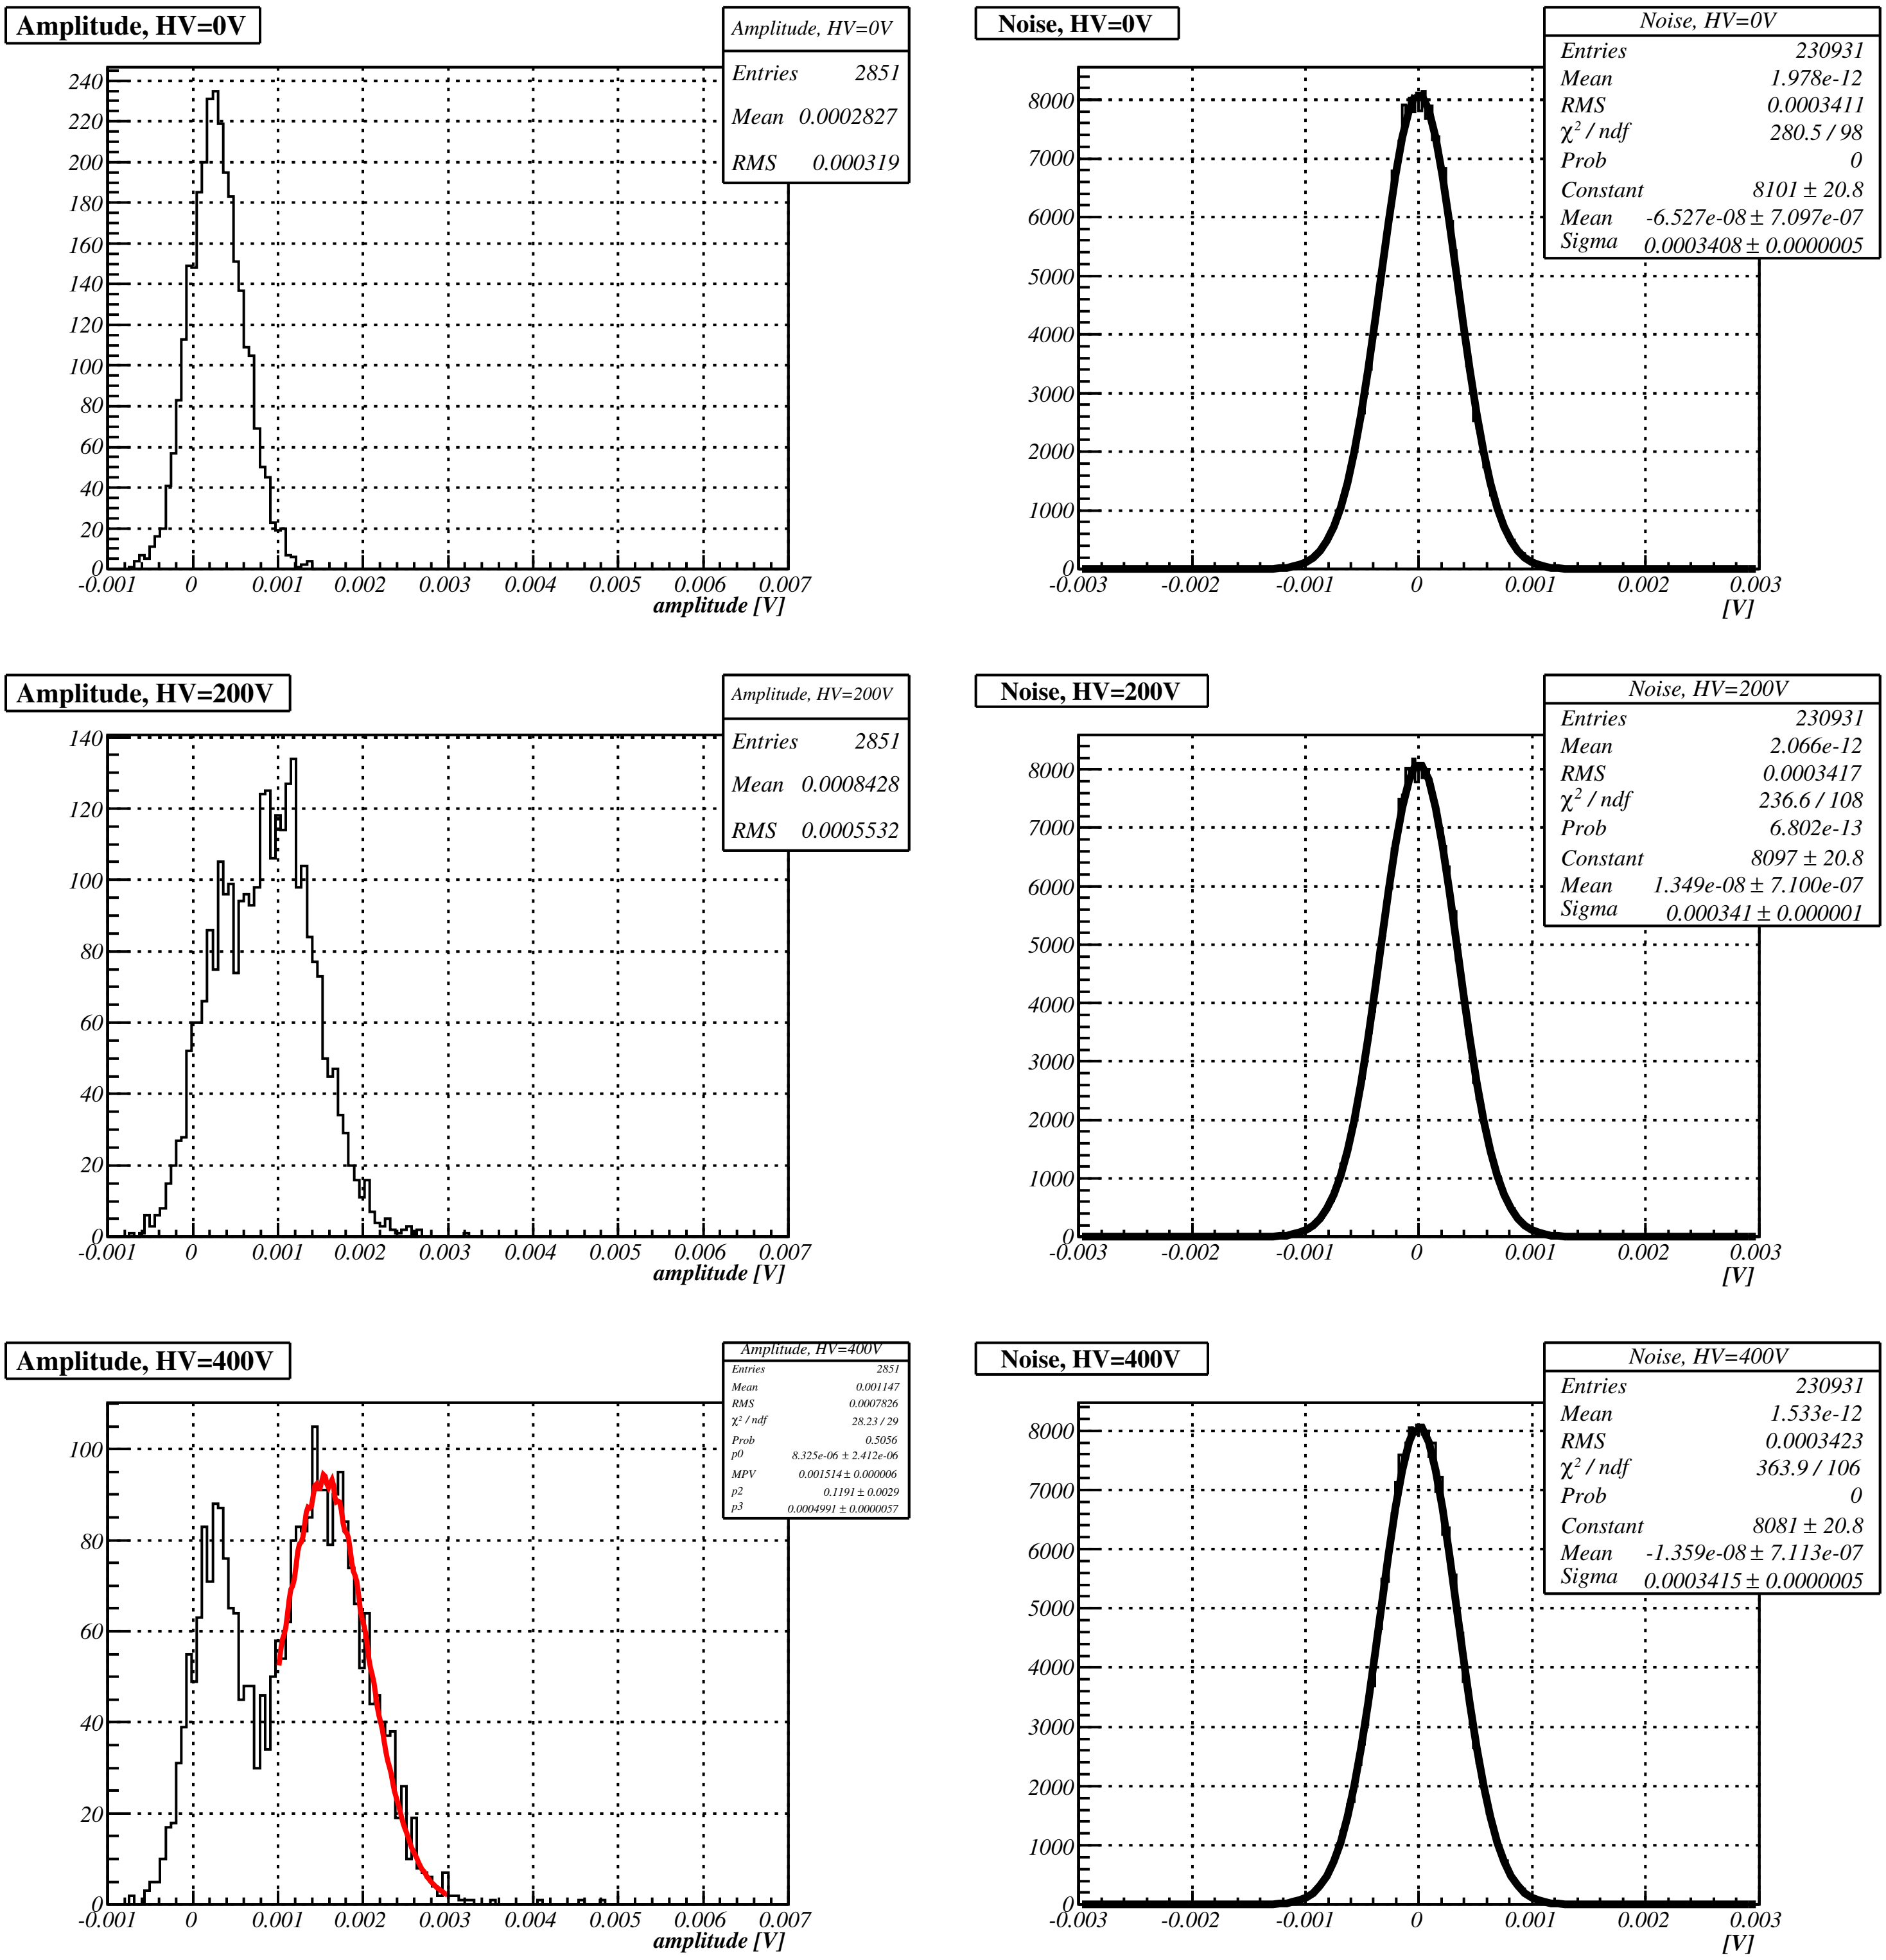

Amplitude, HV=0V
Amplitude, HV=0V
Entries 2851
Mean 0.0002827
RMS 0.000319
amplitude [V]
Noise, HV=0V
Noise, HV=0V
Entries 230931
Mean 1.978e-12
RMS 0.0003411
χ² / ndf 280.5 / 98
Prob 0
Constant 8101 ± 20.8
Mean -6.527e-08 ± 7.097e-07
Sigma 0.0003408 ± 0.0000005
[V]
Amplitude, HV=200V
Amplitude, HV=200V
Entries 2851
Mean 0.0008428
RMS 0.0005532
amplitude [V]
Noise, HV=200V
Noise, HV=200V
Entries 230931
Mean 2.066e-12
RMS 0.0003417
χ² / ndf 236.6 / 108
Prob 6.802e-13
Constant 8097 ± 20.8
Mean 1.349e-08 ± 7.100e-07
Sigma 0.000341 ± 0.000001
[V]
Amplitude, HV=400V
Amplitude, HV=400V
Entries 2851
Mean 0.001147
RMS 0.0007826
χ² / ndf 28.23 / 29
Prob 0.5056
p0 8.325e-06 ± 2.412e-06
MPV 0.001514 ± 0.000006
p2 0.1191 ± 0.0029
p3 0.0004991 ± 0.0000057
amplitude [V]
Noise, HV=400V
Noise, HV=400V
Entries 230931
Mean 1.533e-12
RMS 0.0003423
χ² / ndf 363.9 / 106
Prob 0
Constant 8081 ± 20.8
Mean -1.359e-08 ± 7.113e-07
Sigma 0.0003415 ± 0.0000005
[V]

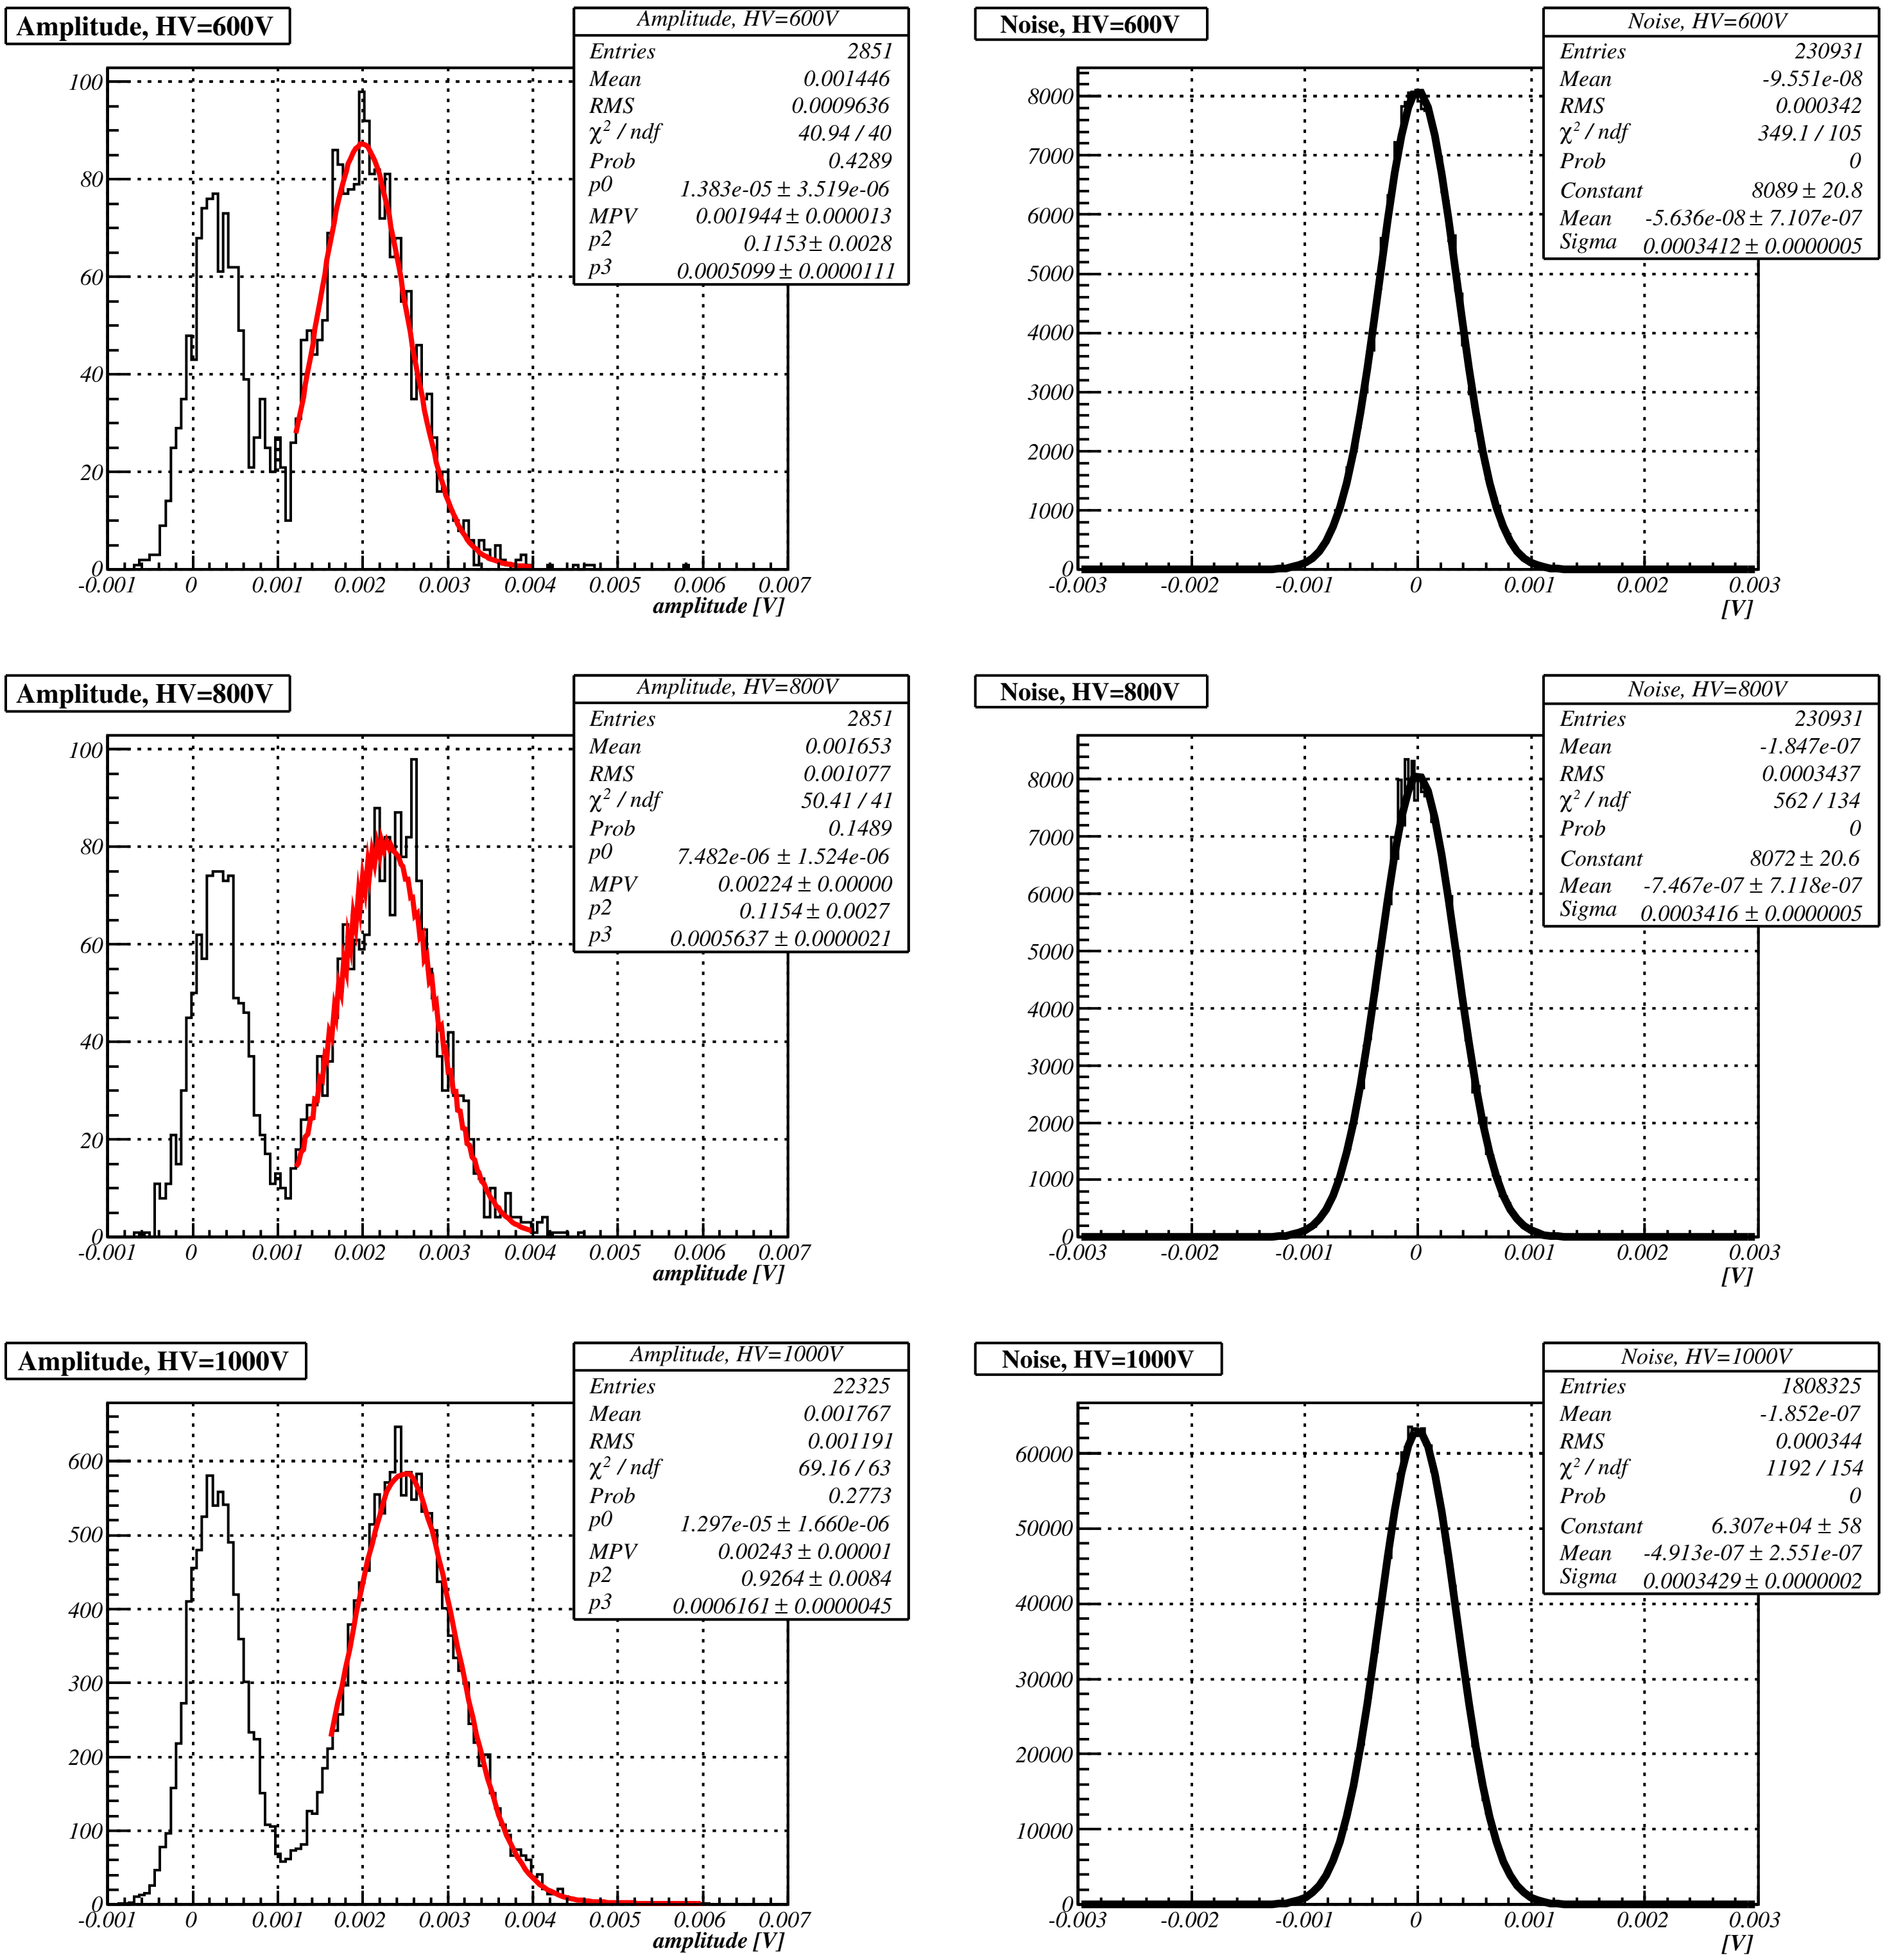
Amplitude, HV=600V
Amplitude, HV=600V
Entries 2851
Mean 0.001446
RMS 0.0009636
χ² / ndf 40.94 / 40
Prob 0.4289
p0 1.383e-05 ± 3.519e-06
MPV 0.001944 ± 0.000013
p2 0.1153 ± 0.0028
p3 0.0005099 ± 0.0000111
amplitude [V]
Noise, HV=600V
Noise, HV=600V
Entries 230931
Mean -9.551e-08
RMS 0.000342
χ² / ndf 349.1 / 105
Prob 0
Constant 8089 ± 20.8
Mean -5.636e-08 ± 7.107e-07
Sigma 0.0003412 ± 0.0000005
[V]
Amplitude, HV=800V
Amplitude, HV=800V
Entries 2851
Mean 0.001653
RMS 0.001077
χ² / ndf 50.41 / 41
Prob 0.1489
p0 7.482e-06 ± 1.524e-06
MPV 0.00224 ± 0.00000
p2 0.1154 ± 0.0027
p3 0.0005637 ± 0.0000021
amplitude [V]
Noise, HV=800V
Noise, HV=800V
Entries 230931
Mean -1.847e-07
RMS 0.0003437
χ² / ndf 562 / 134
Prob 0
Constant 8072 ± 20.6
Mean -7.467e-07 ± 7.118e-07
Sigma 0.0003416 ± 0.0000005
[V]
Amplitude, HV=1000V
Amplitude, HV=1000V
Entries 22325
Mean 0.001767
RMS 0.001191
χ² / ndf 69.16 / 63
Prob 0.2773
p0 1.297e-05 ± 1.660e-06
MPV 0.00243 ± 0.00001
p2 0.9264 ± 0.0084
p3 0.0006161 ± 0.0000045
amplitude [V]
Noise, HV=1000V
Noise, HV=1000V
Entries 1808325
Mean -1.852e-07
RMS 0.000344
χ² / ndf 1192 / 154
Prob 0
Constant 6.307e+04 ± 58
Mean -4.913e-07 ± 2.551e-07
Sigma 0.0003429 ± 0.0000002
[V]

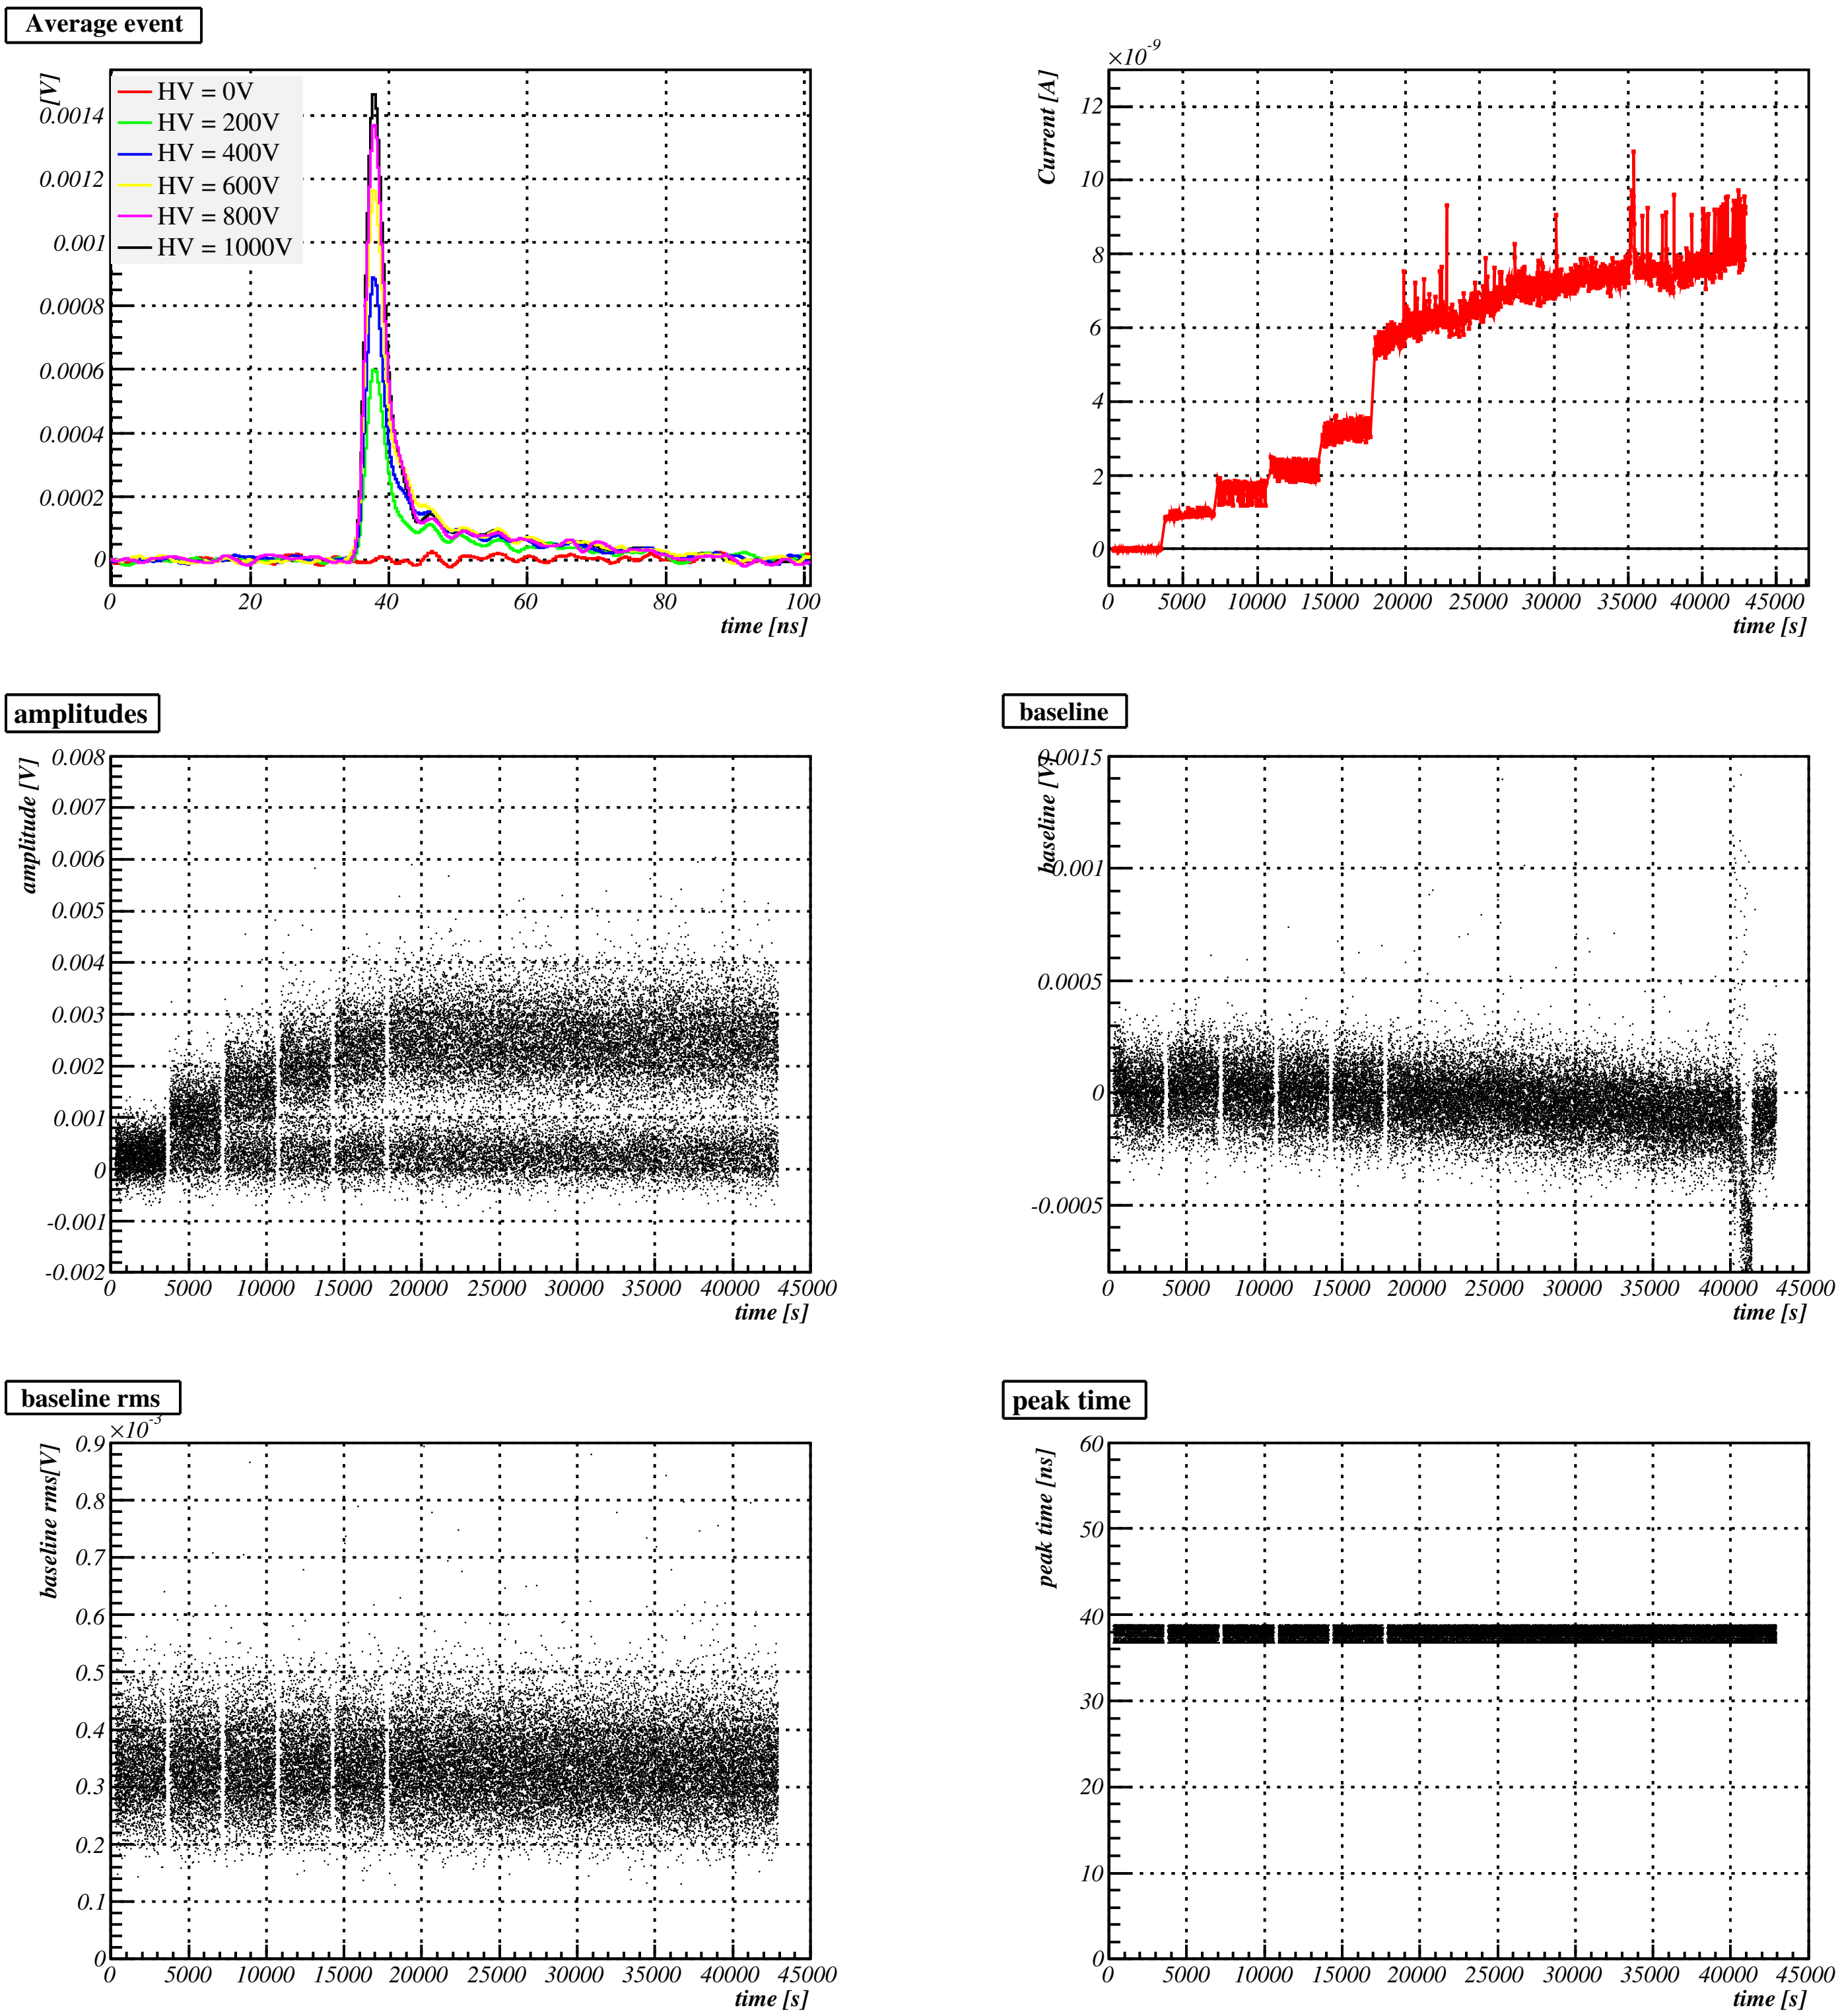
Average event
HV = 0V
HV = 200V
HV = 400V
HV = 600V
HV = 800V
HV = 1000V
[V]
time [ns]
×10^-9
Current [A]
time [s]
amplitudes
amplitude [V]
time [s]
baseline
baseline [V]
time [s]
baseline rms
×10^-3
baseline rms[V]
time [s]
peak time
peak time [ns]
time [s]

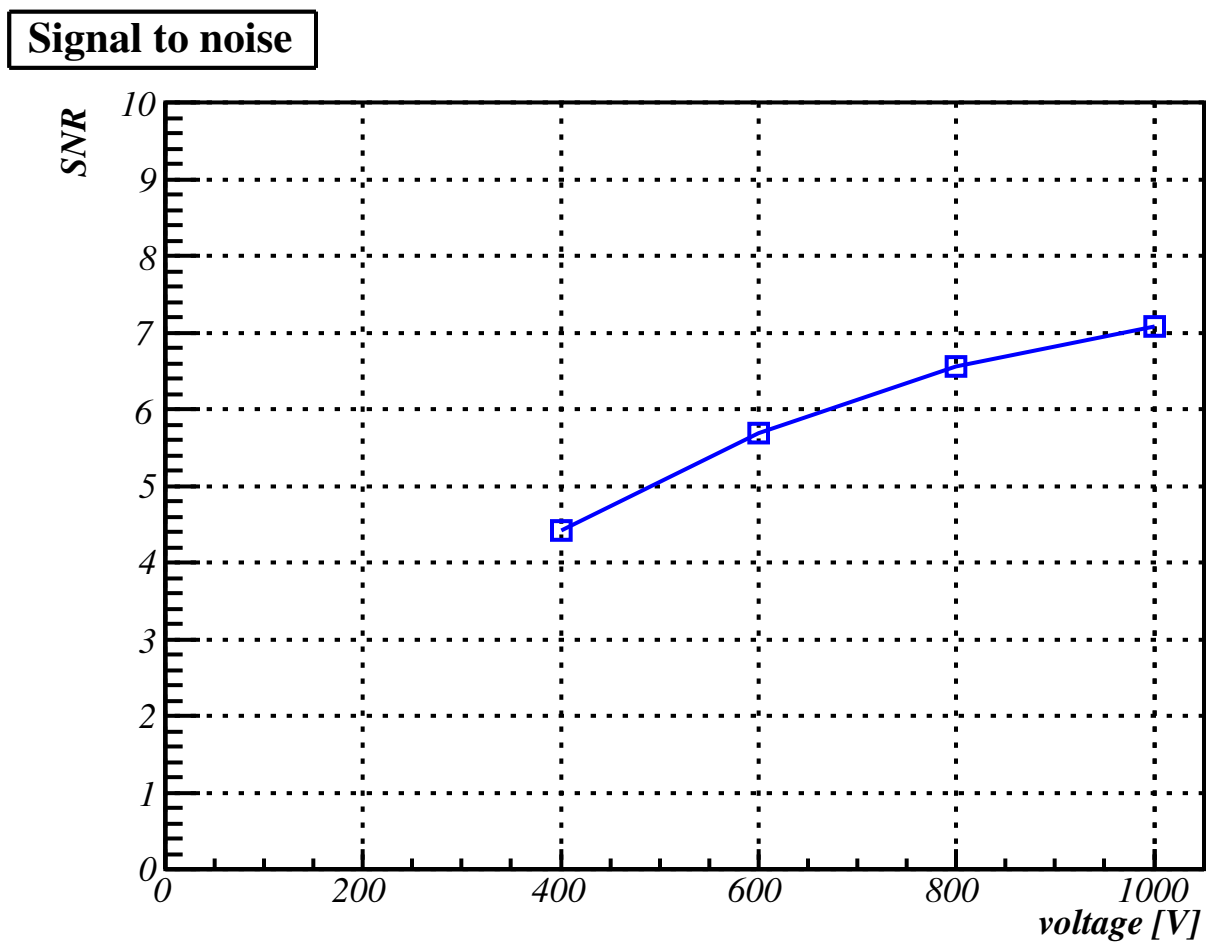

SP_071114190617_Fotec406_A230-10_A230-8_ceramic15_measurement1.xls